



自體骨取骨環鑽



纽白特

**NeoBiotech**  
Satisfaction to Dentists



## 一般情況怎麼取得自體骨呢?



环钻




骨劈开



骨块变成骨片



但這樣的骨片做骨移植不太好用

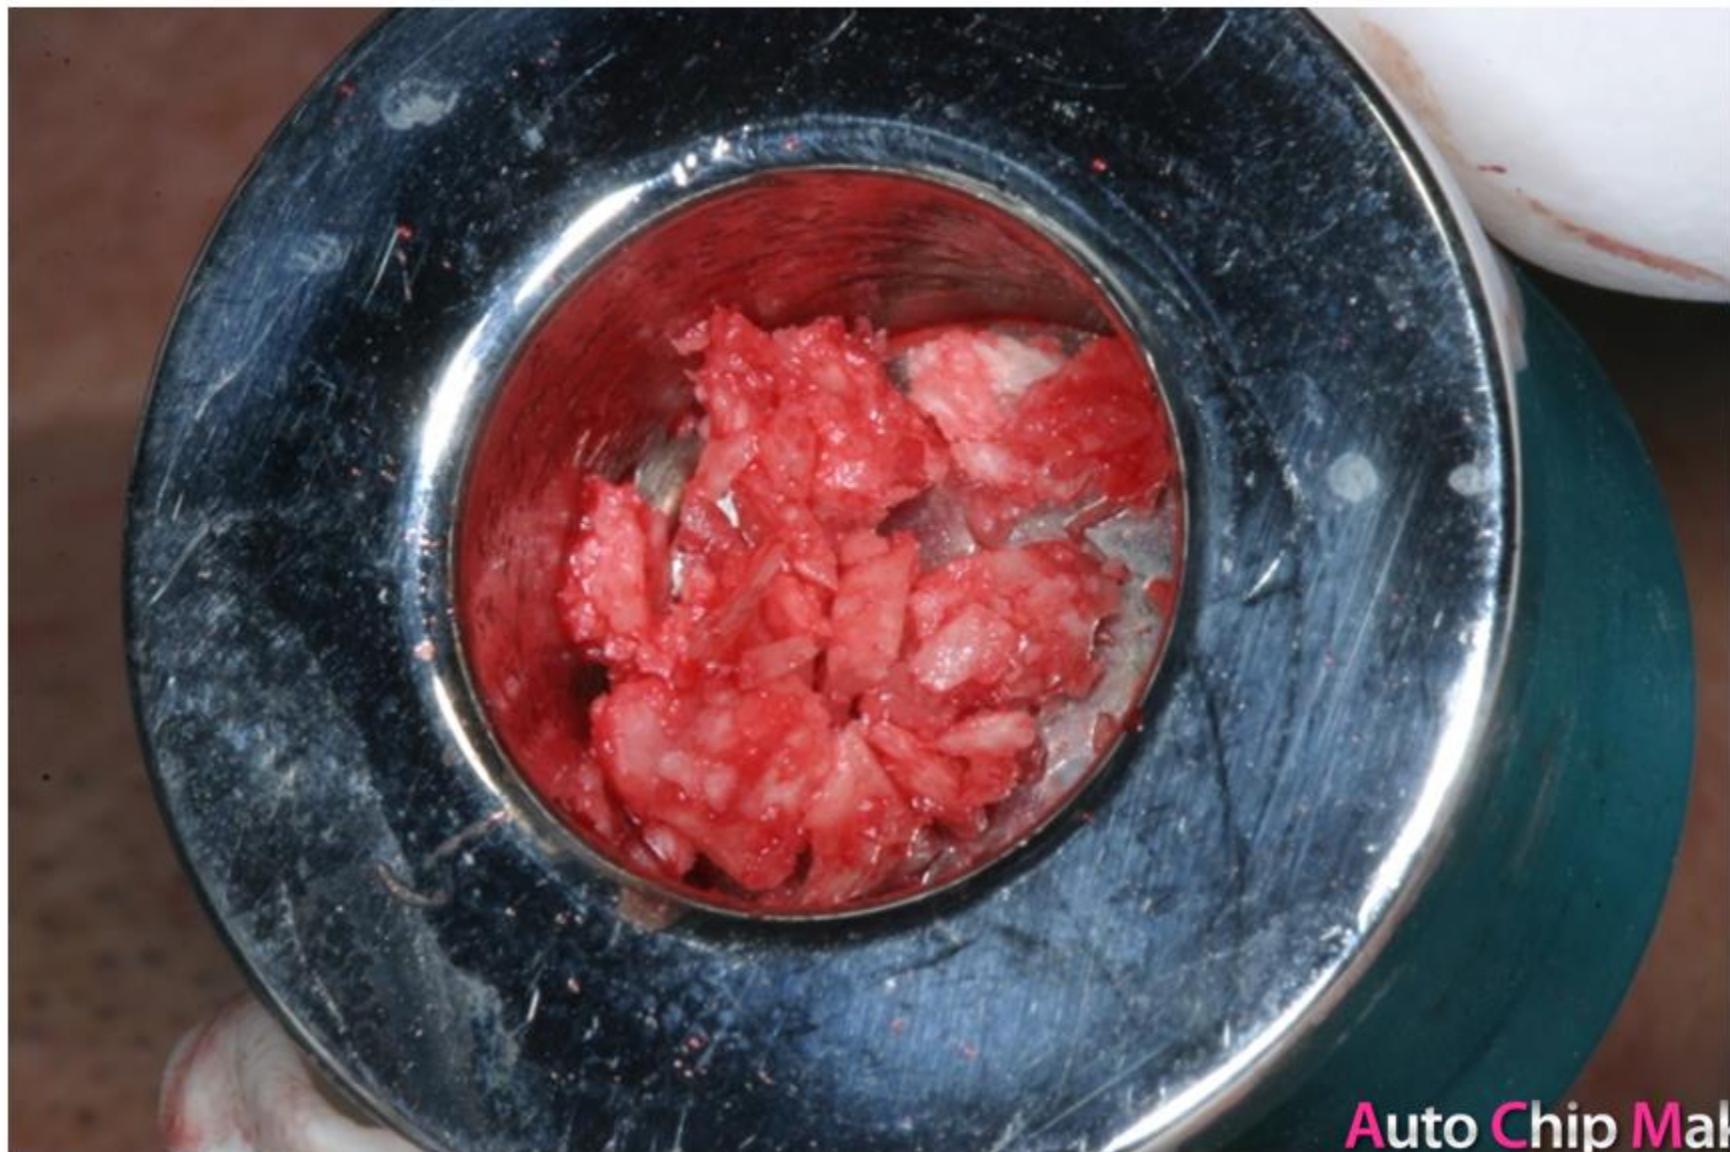


Auto Chip Maker



紐白特有解決方案，簡單，快捷！

# Auto Chip Maker


자가골 채취를 보다 쉽고 안전하게!!!

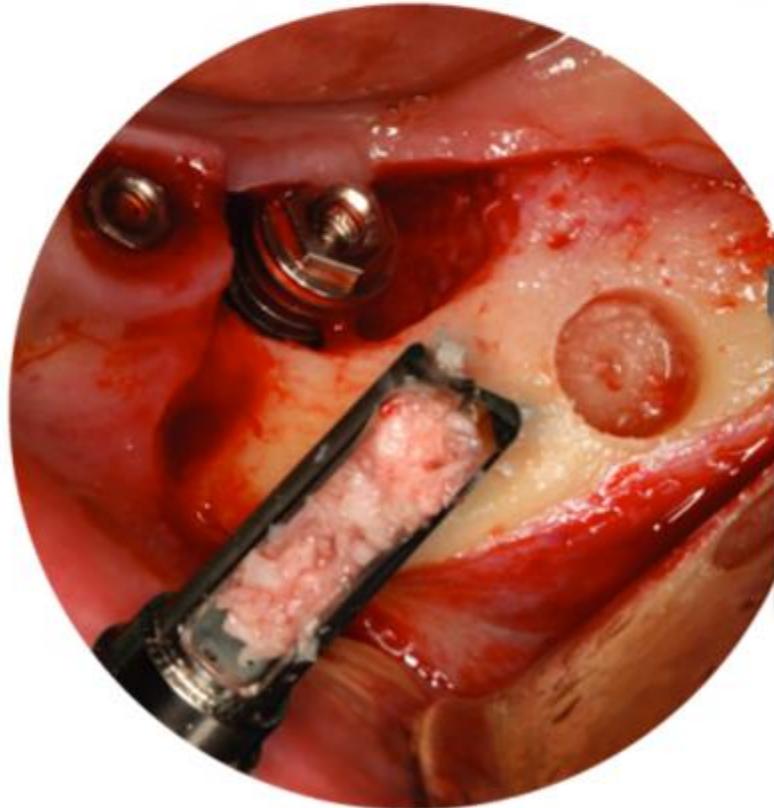

Auto Chip Maker



## ACM取骨環鑽

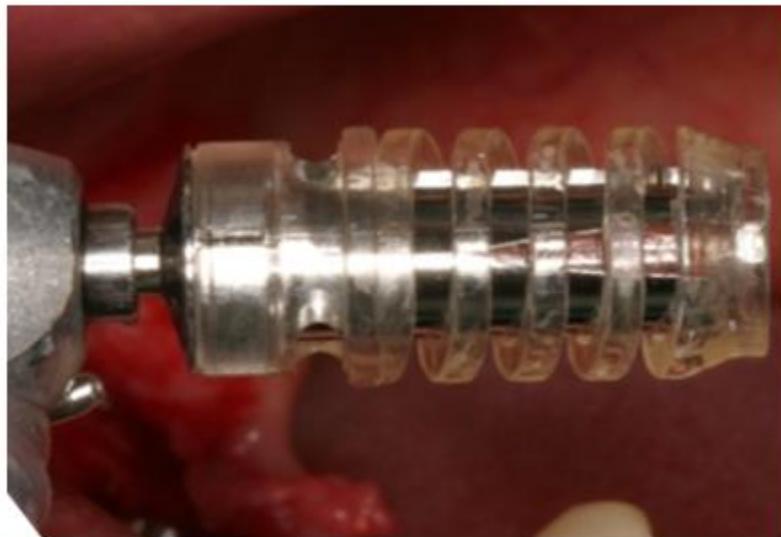

Auto Chip Maker



使用後



在30秒~1分鐘內能收集到質量好的1cc骨屑

Auto Chip Maker



## 尺寸, 直徑分類




1盒-1跟鑽+7個停止環





## 安全設計

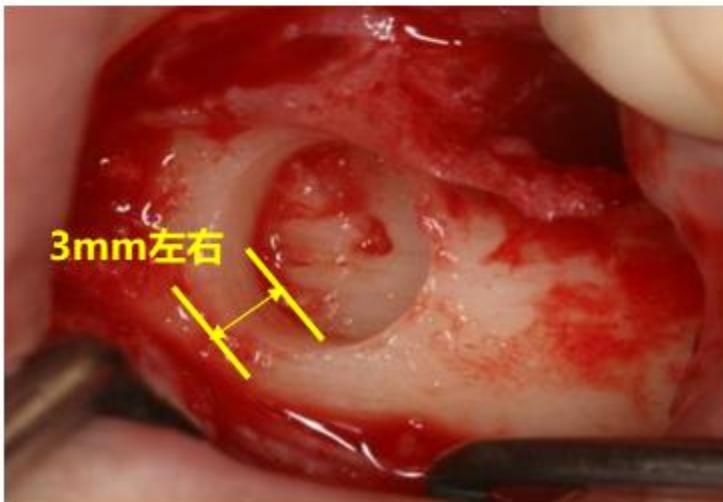

因為彈簧可以壓住後停止深度,不會超過3~4mm

無注水下,鑽速80rpm(慢速)

Auto Chip Maker





Auto Chip Maker



纽白特  
NeoBiotech

## 臨床使用(下顎頰側)

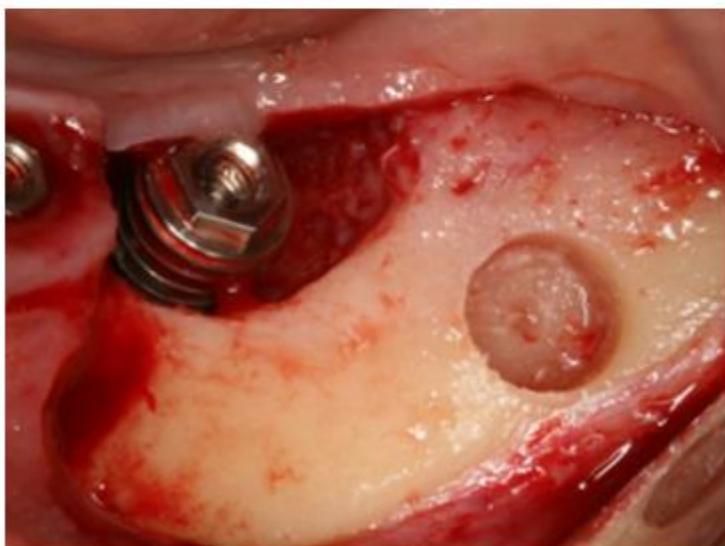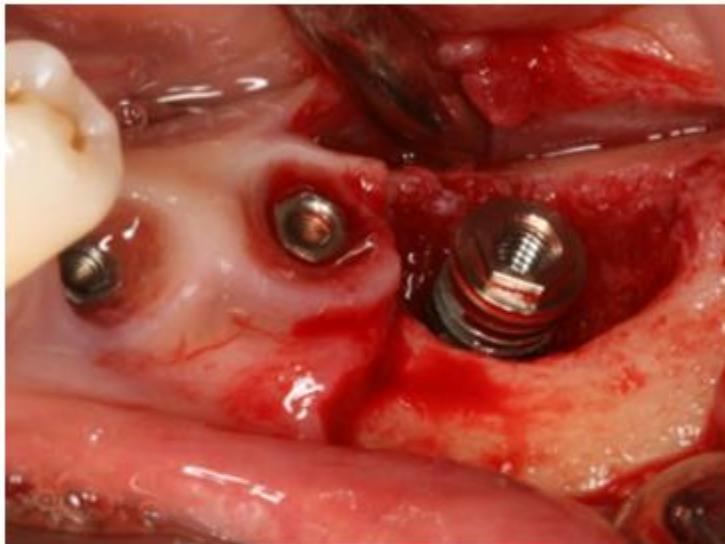


Auto Chip Maker



纽白特  
NeoBiotech

## 臨床使用(下顎頰側)


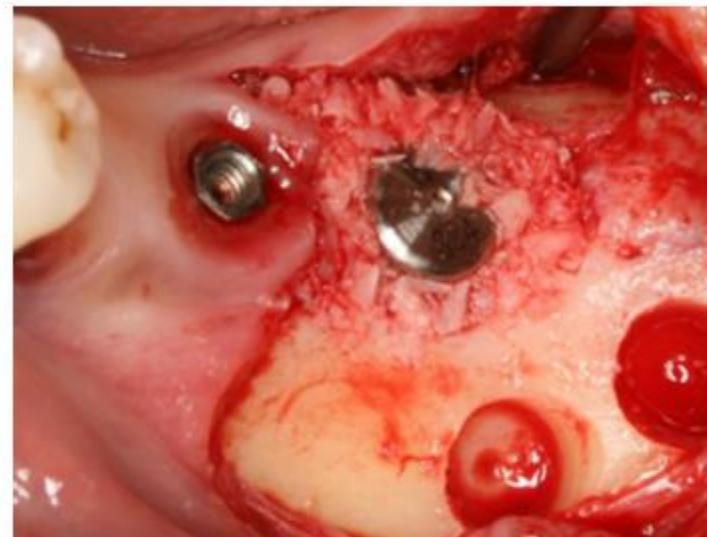


Auto Chip Maker



纽白特  
NeoBiotech

## 臨床使用(下顎頰側)


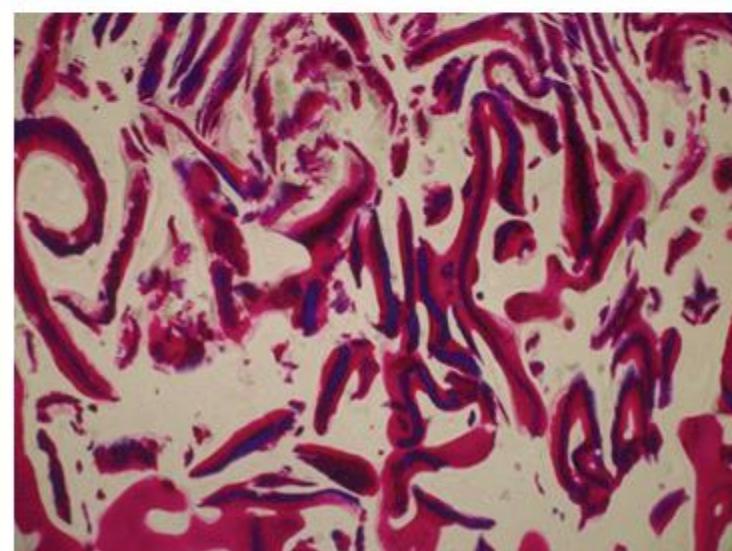
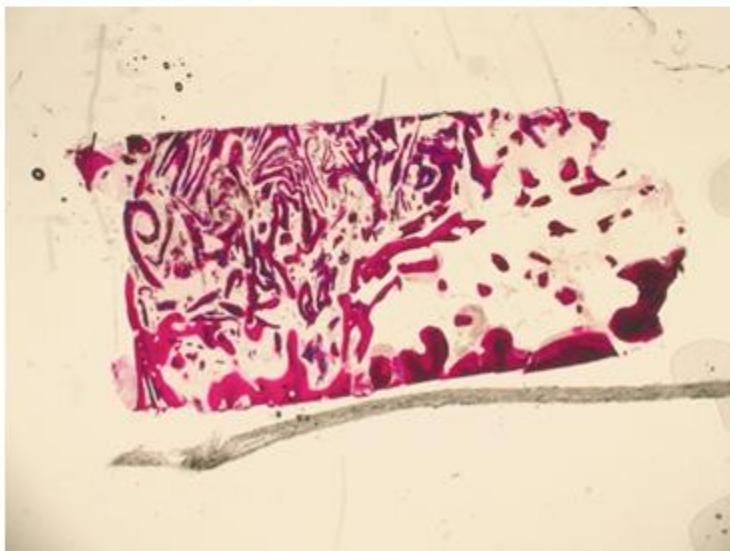


Auto Chip Maker



纽白特  
NeoBiotech


## 臨床使用(上顎頰側)

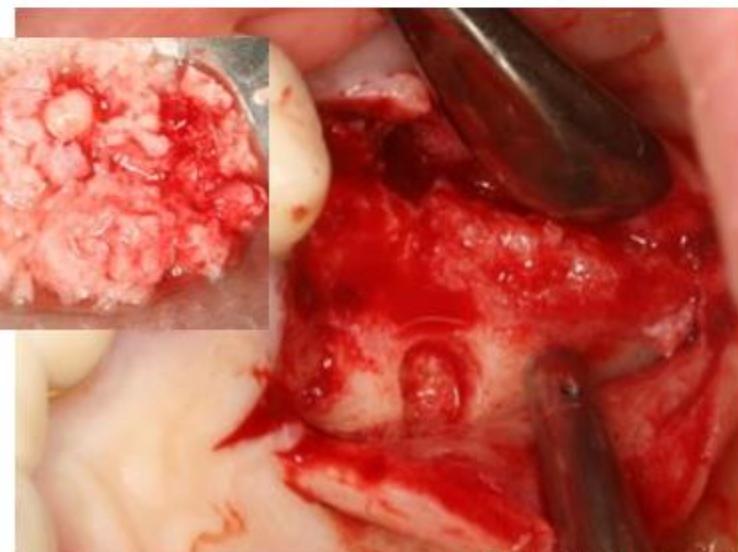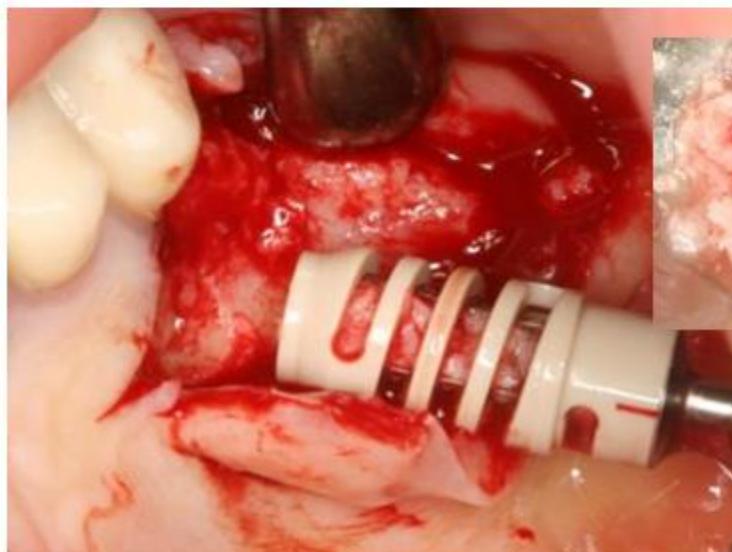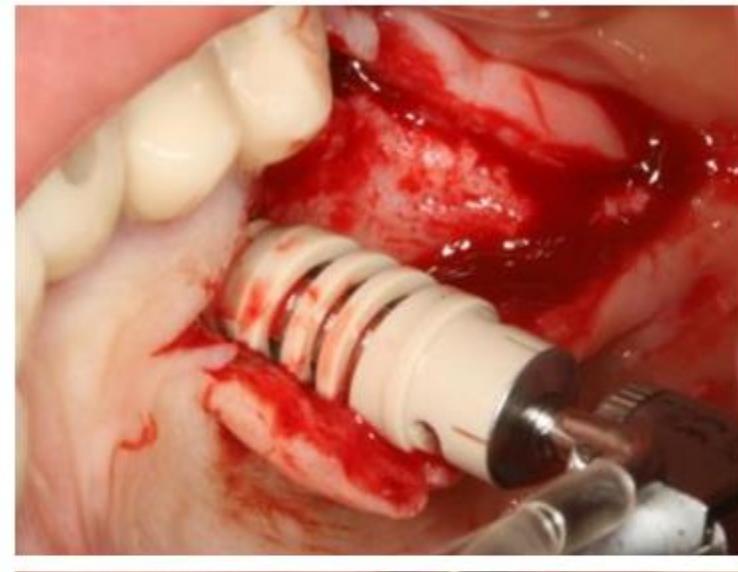



Auto Chip Maker




## | 臨床病例



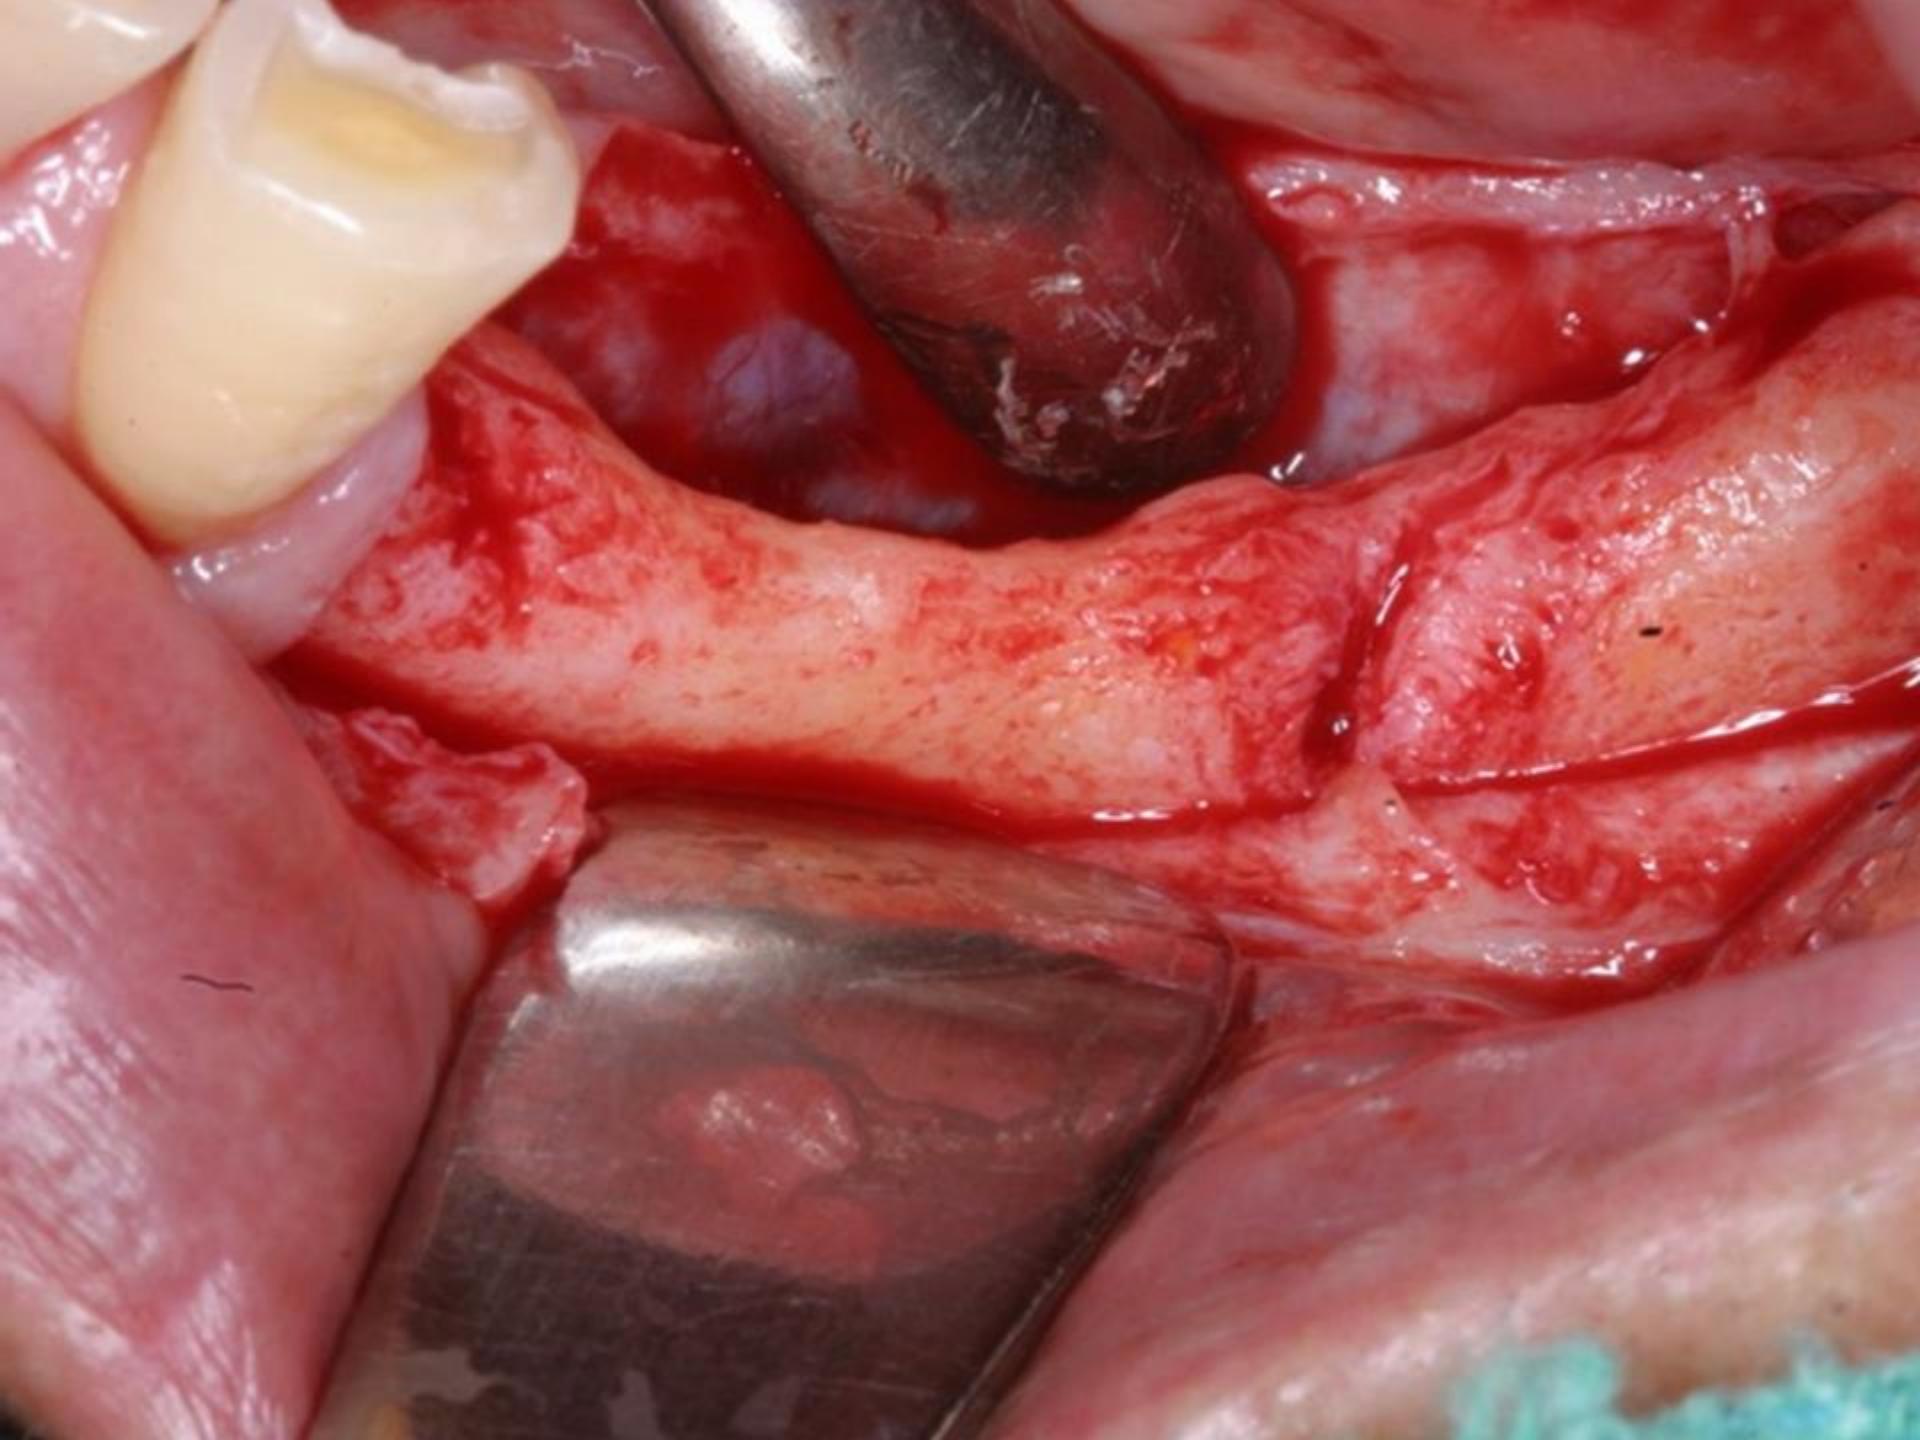


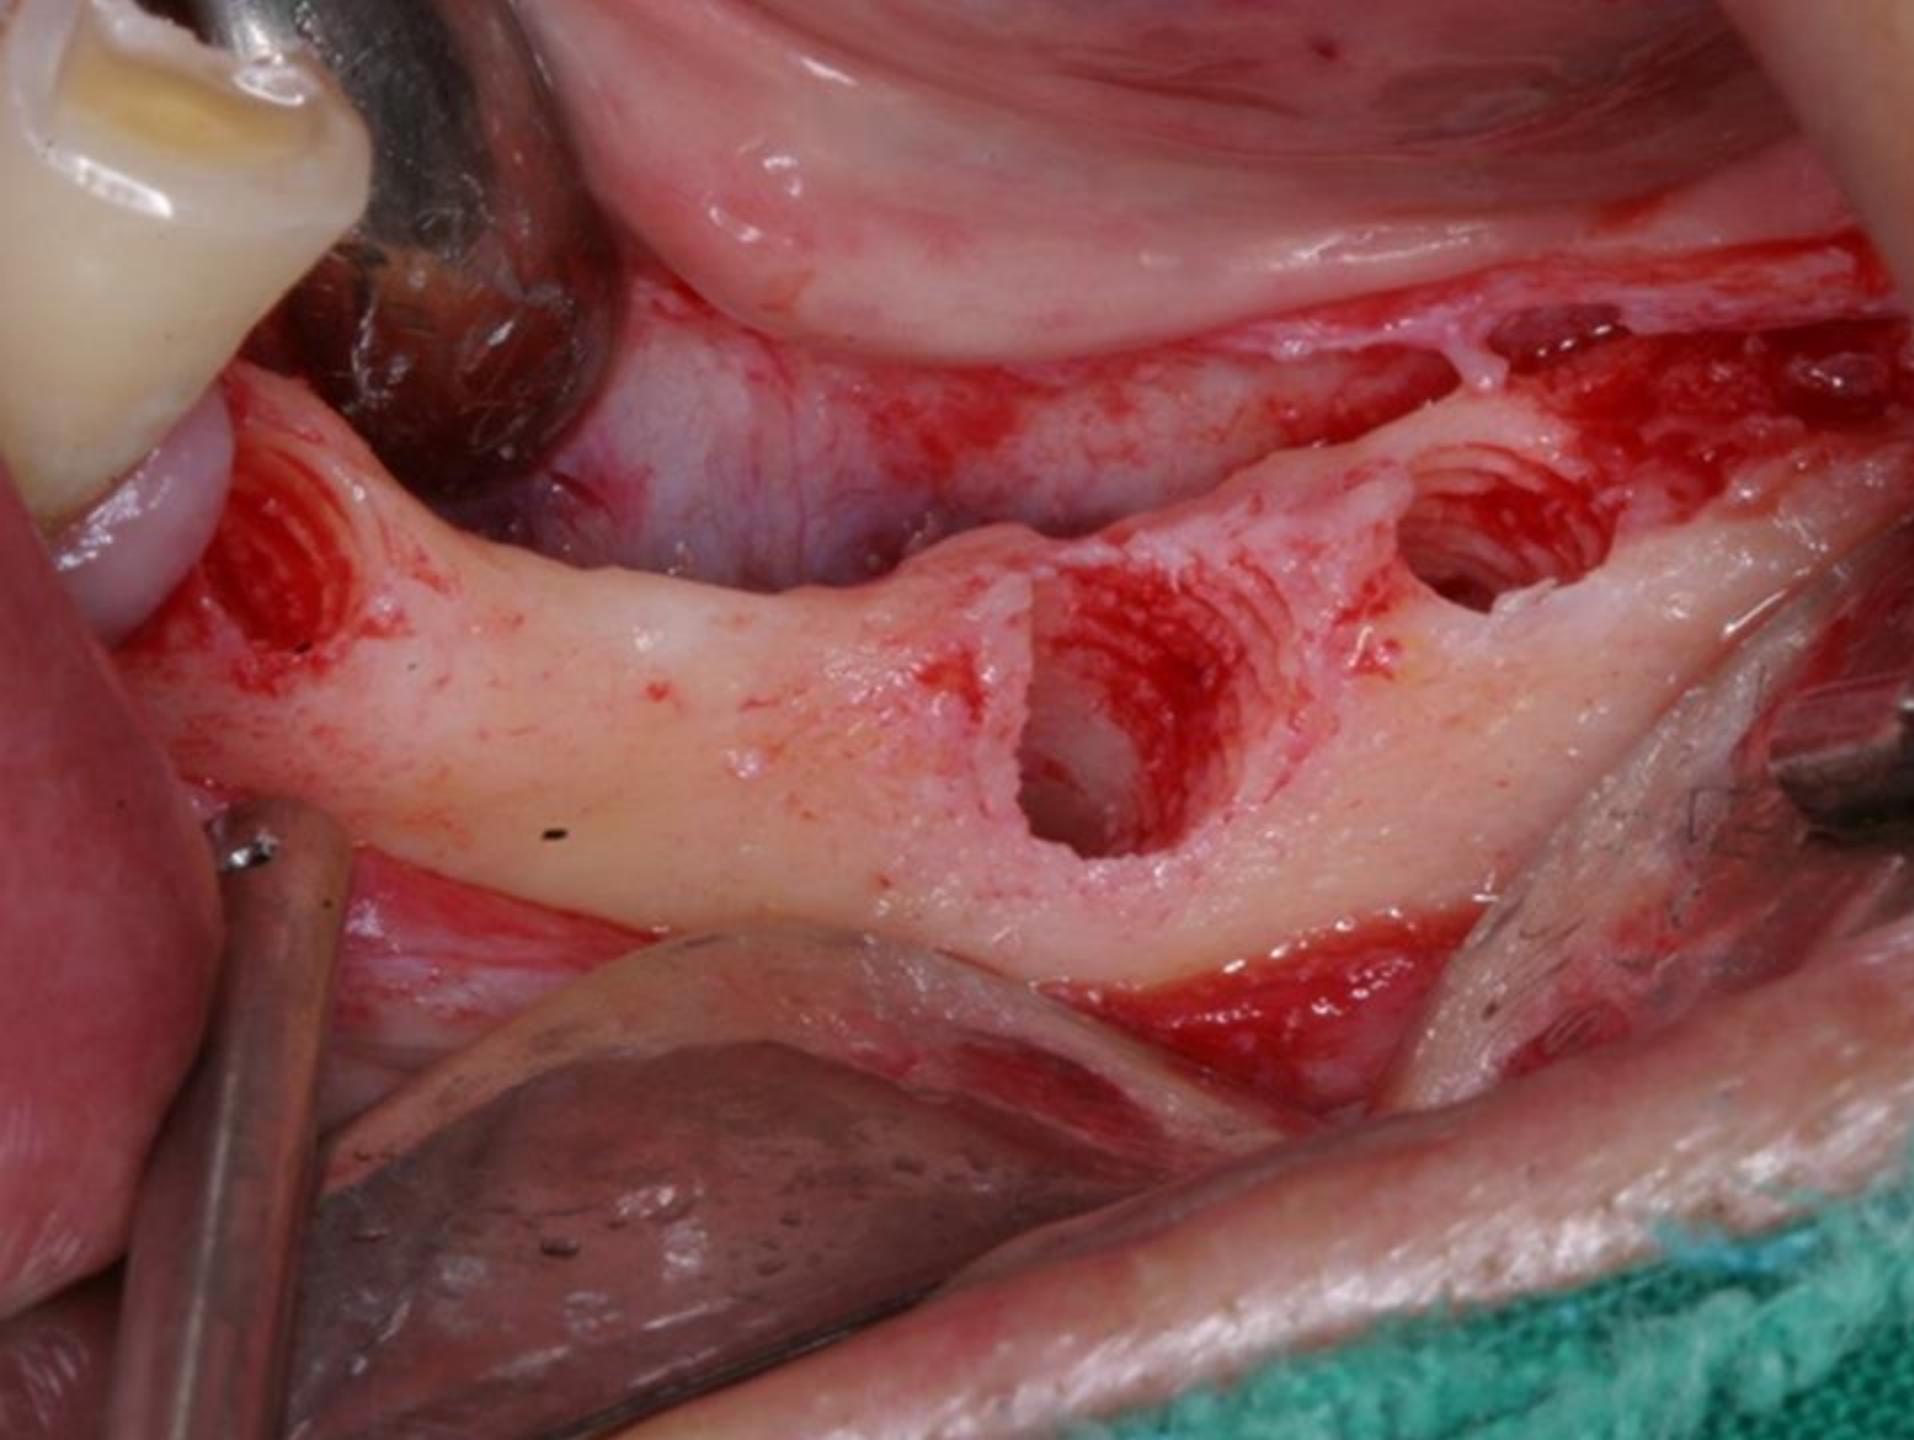


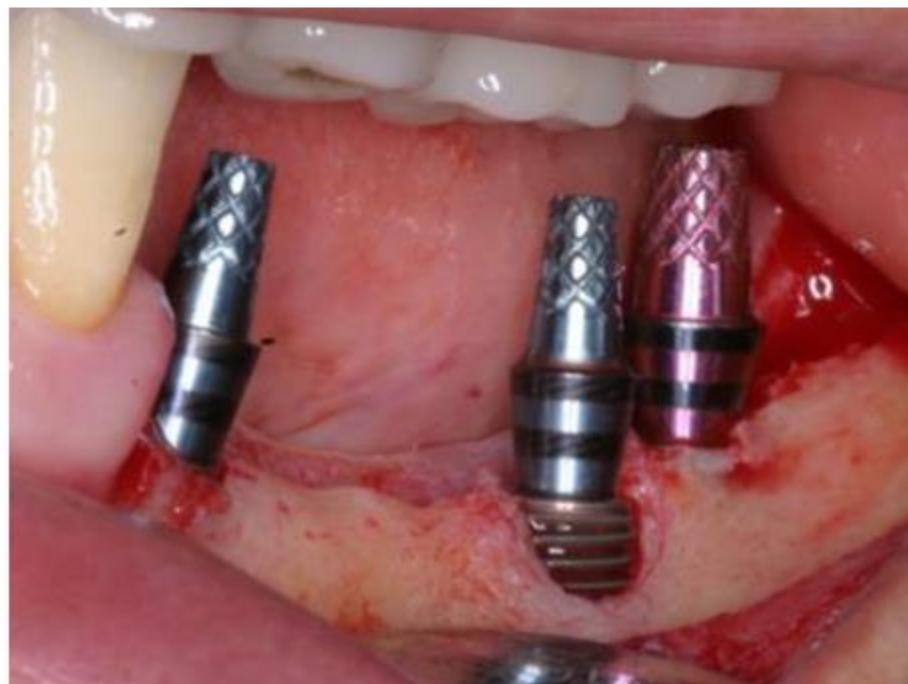


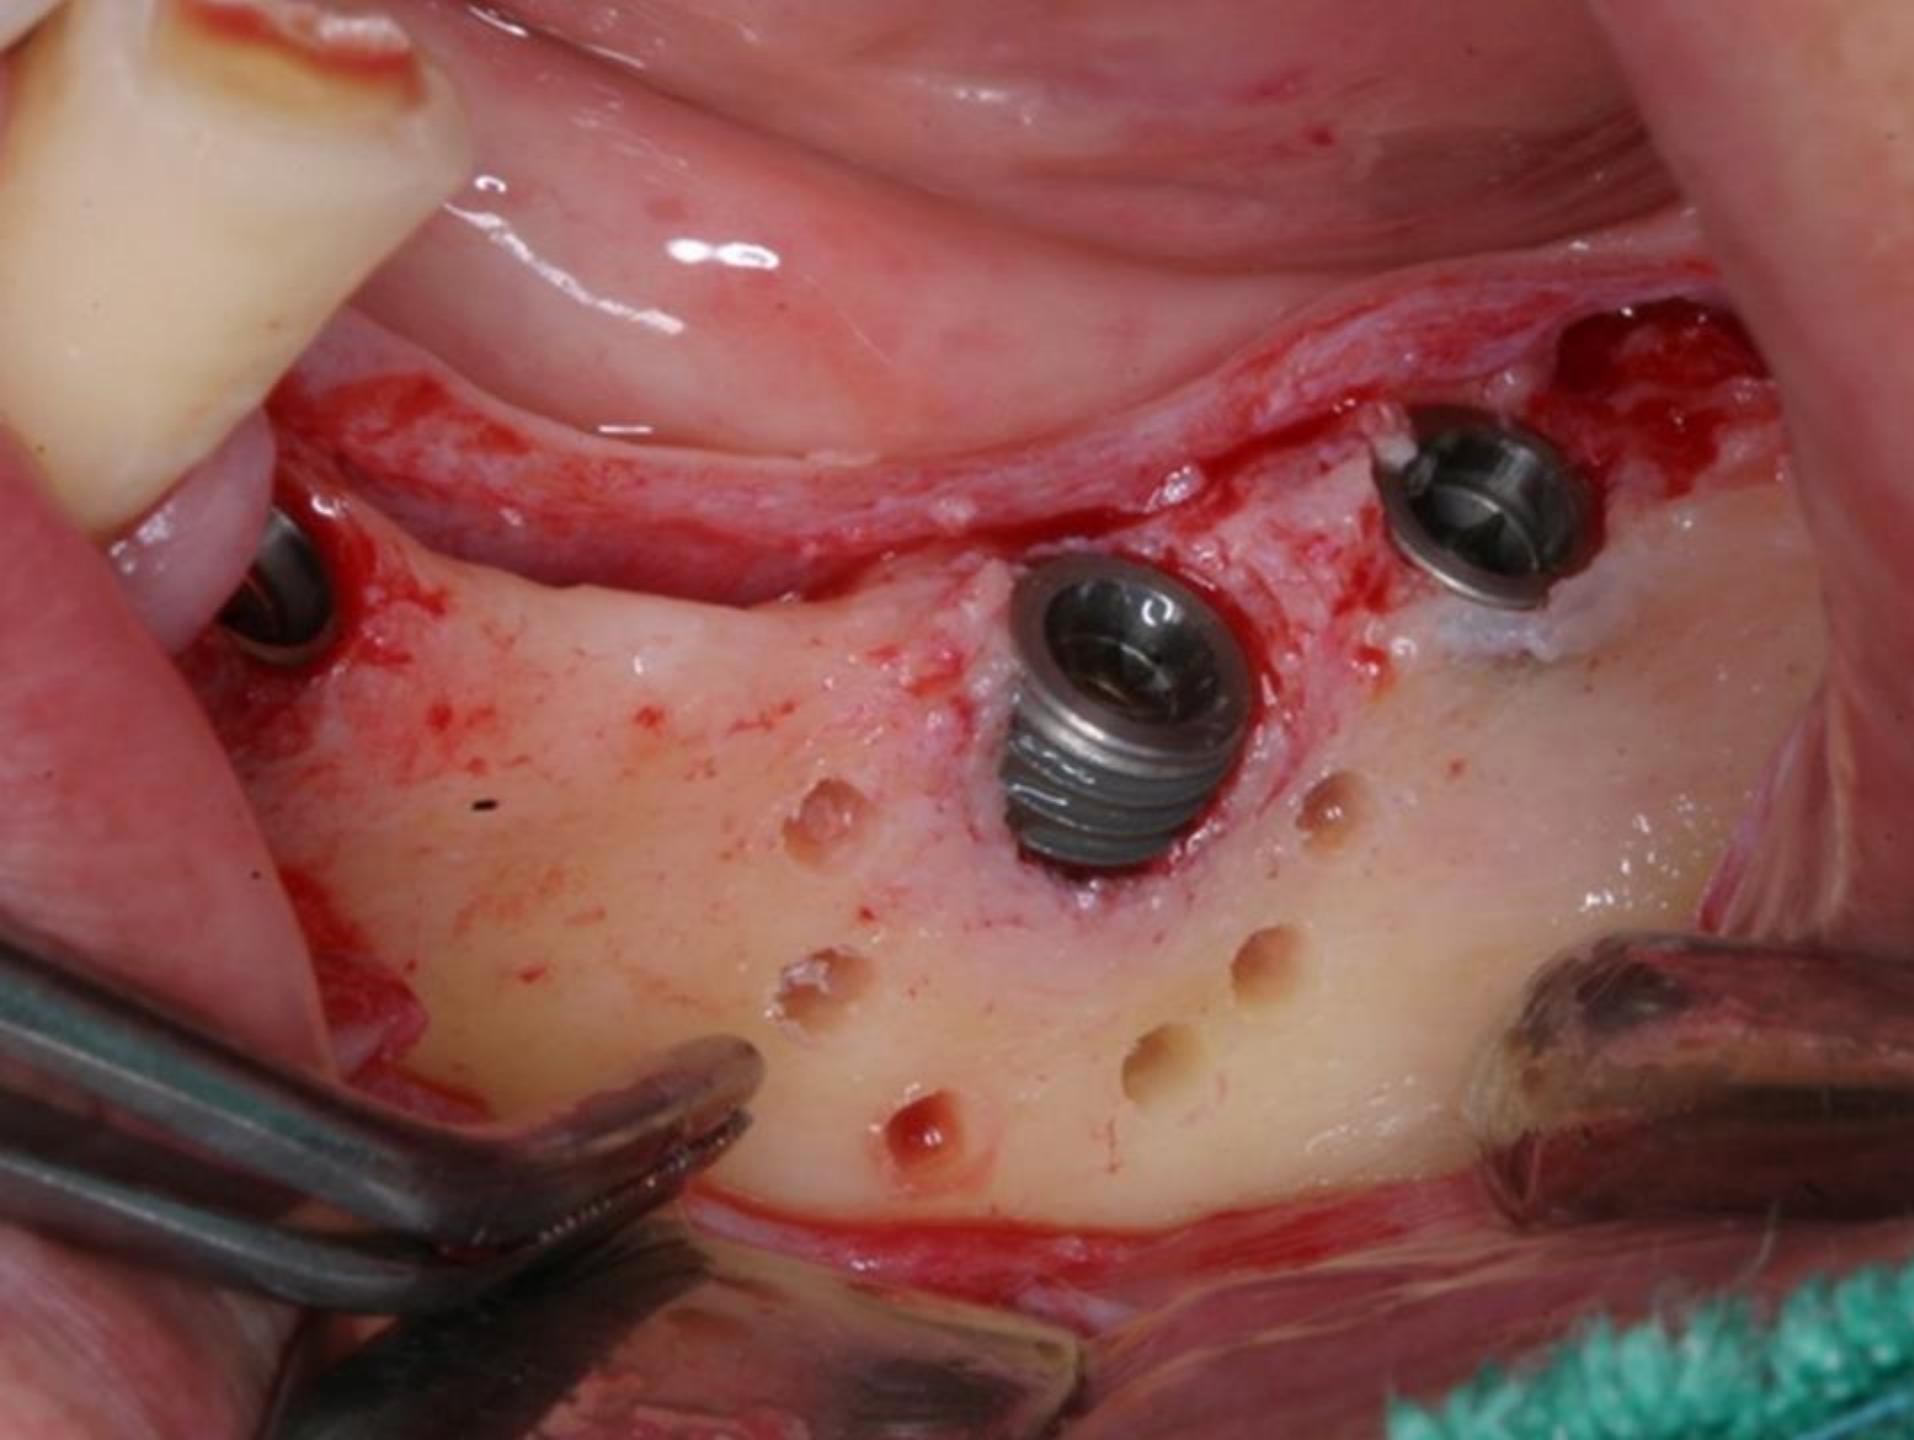



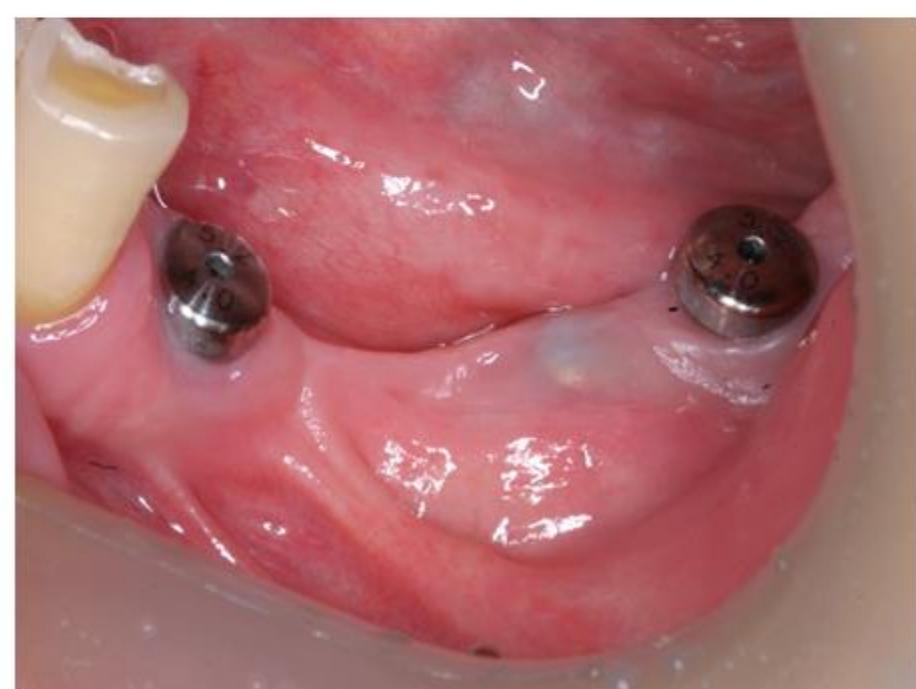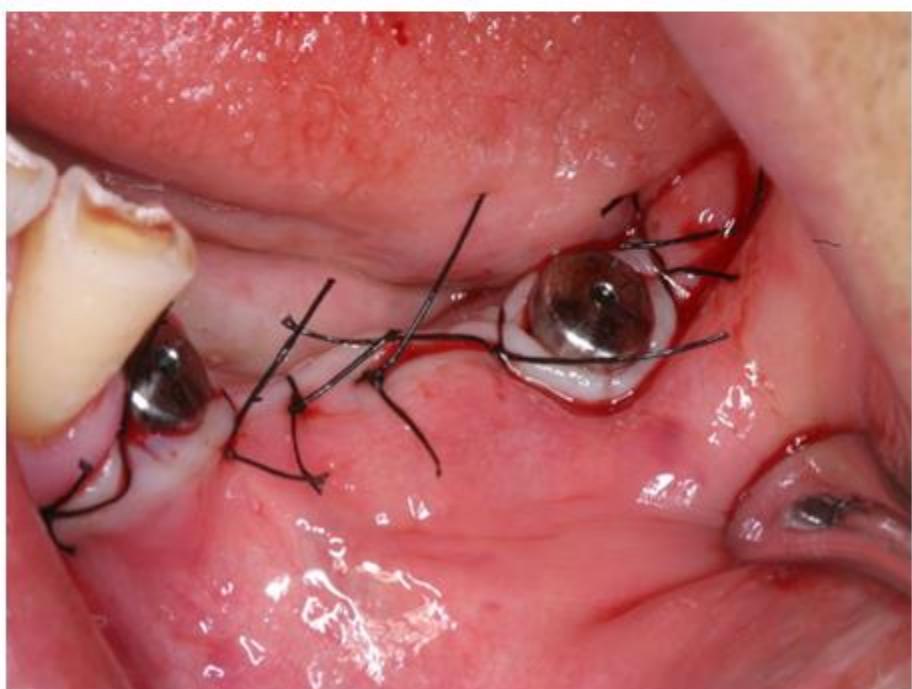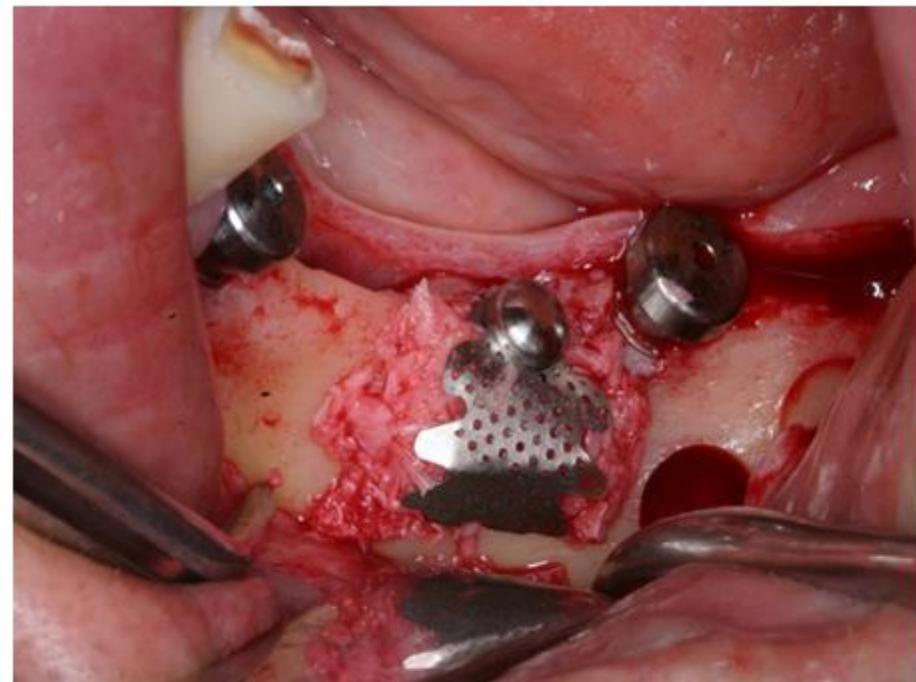

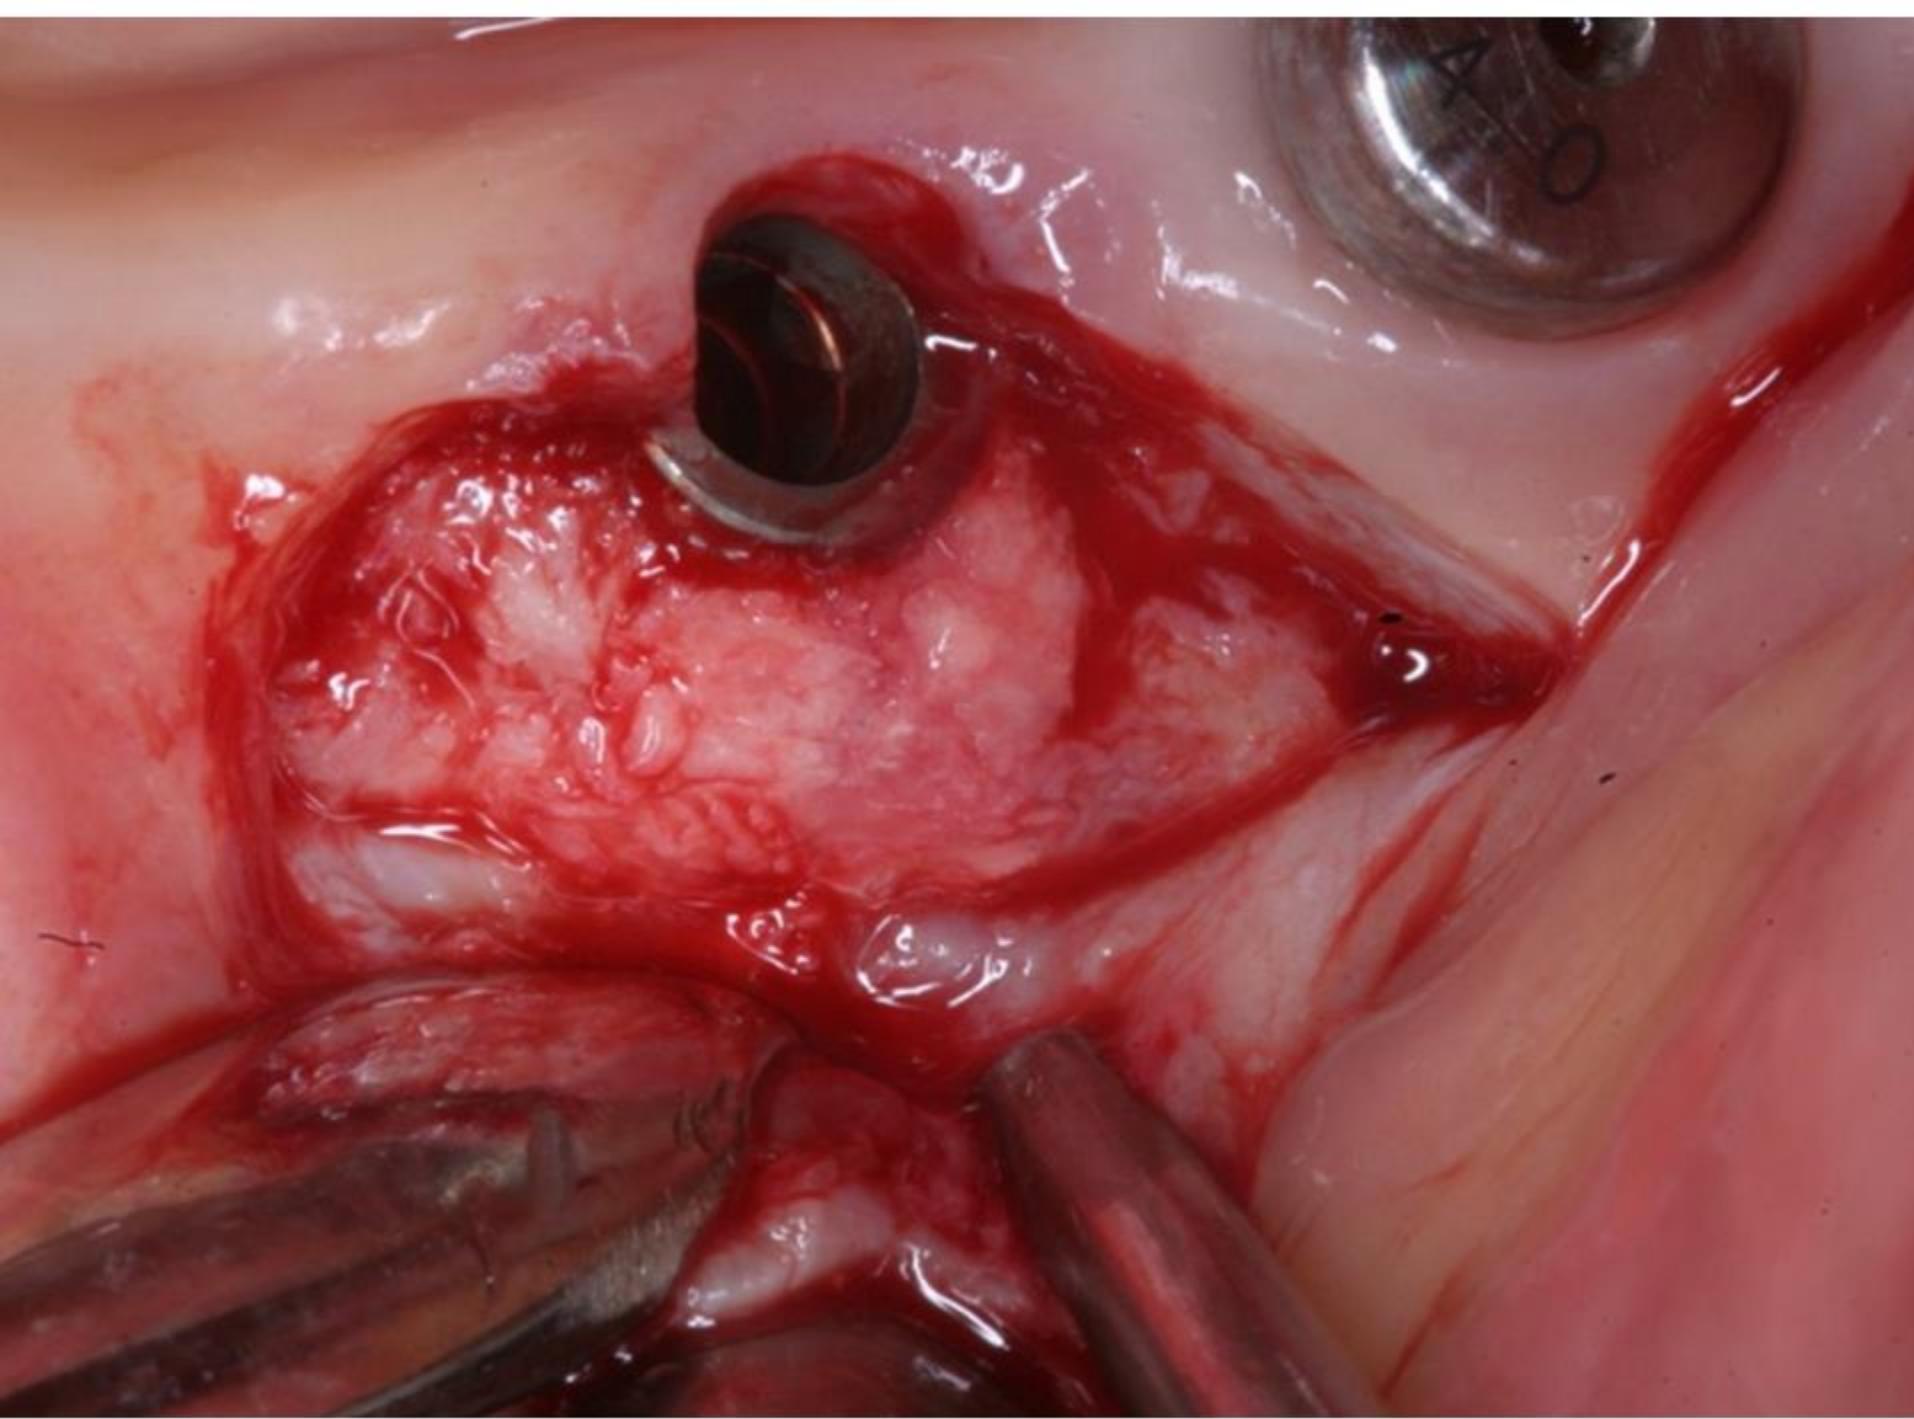

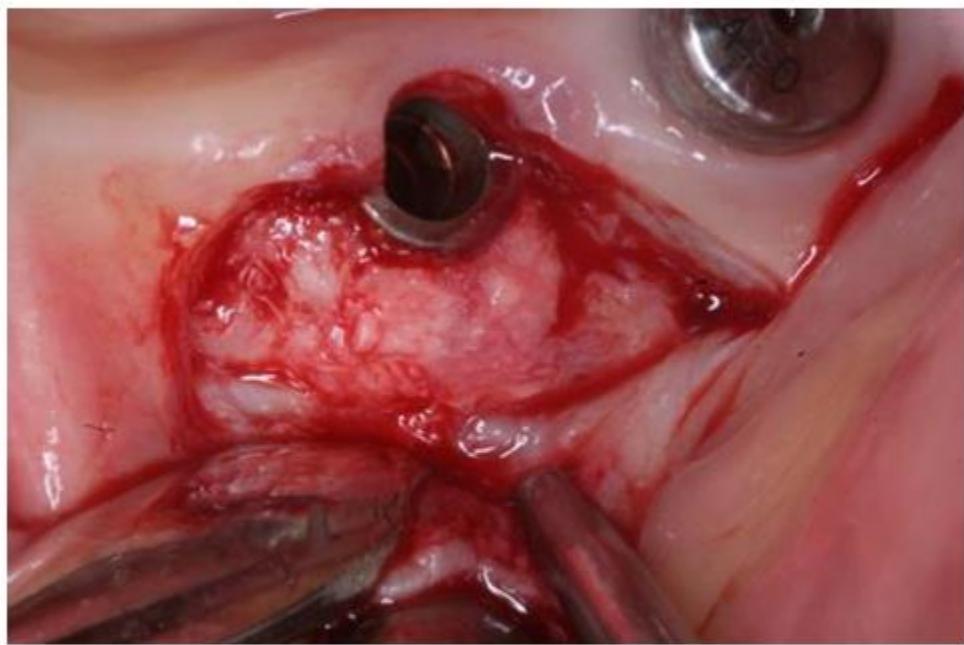

纽白特

---

**NeoBiotech**

Satisfaction to Dentists